

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch








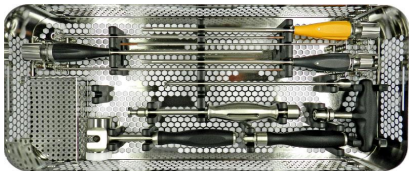
Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuySynthes.com



**L1100001572**

**Conduit Curved TLIF Instrumente**

**Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		<b>Tray 01</b>				
1	PET00910	T-Handgriff		1	ST	B01T01
2	PET00920	Gerader Handgriff		1	ST	B01T01
3	PET60250	HAMMER		1	ST	B01T01
4	PET60251	Schlaghammer		1	ST	B01T01
5	TET30201	Großer Impaktor		1	ST	B01T01
6	TFT20101	Probeimplantat Einsetzer SH Verbindung		1	ST	B01T01
7	TFT30101	Implantateinsetzer SH Verbindung		2	ST	B01T01
8	TEC00101	TLIF Instrumenten Tray groß		1	ST	B01T01

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service





Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuySynthes.com



## L1100001572

## Conduit Curved TLIF Instrumente

		Deckel zu TEC00101		1	ST	B01T01
Box01/01	<b>Tray 02</b>					
9	PET10050	Bandscheibenraumöffner		1	ST	B01T02
10	PET10710	DISTRAKTOR Höhe 7 mm		1	ST	B01T02
11	PET10810	DISTRAKTOR Höhe 8 mm		1	ST	B01T02
12	PET10910	DISTRAKTOR Höhe 9 mm		1	ST	B01T02
13	PET11010	DISTRAKTOR Höhe 10 mm		1	ST	B01T02
14	PET11110	DISTRAKTOR Höhe 11 mm		1	ST	B01T02
15	PET11210	DISTRAKTOR Höhe 12 mm		1	ST	B01T02
16	PET11310	DISTRAKTOR Höhe 13 mm		1	ST	B01T02
17	PET11410	DISTRAKTOR Höhe 14 mm		1	ST	B01T02
18	PET11510	DISTRAKTOR Höhe 15 mm		1	ST	B01T02
19	PFT10700	TLIF Schaber Höhe 7 mm		1	ST	B01T02
20	PFT10800	TLIF Schaber Höhe 8 mm		1	ST	B01T02
21	PFT10900	TLIF Schaber Höhe 9 mm		1	ST	B01T02
22	PFT11000	TLIF Schaber Höhe 10 mm		1	ST	B01T02
23	PFT11100	TLIF Schaber Höhe 11 mm		1	ST	B01T02
24	PFT11200	TLIF Schaber Höhe 12 mm		1	ST	B01T02
25	PFT11300	TLIF Schaber Höhe 13 mm		1	ST	B01T02
26	PFT11400	TLIF Schaber Höhe 14 mm		1	ST	B01T02
27	PFT11500	TLIF Schaber Höhe 15 mm		1	ST	B01T02
28	TFT00728	Probeimplantat Höhe 7 mm 0° 28/10		1	ST	B01T02
29	TFT00732	Probeimplantat Höhe 7 mm 0° 32/12		1	ST	B01T02
30	TFT00828	Probeimplantat Höhe 8 mm 0° 28/10		1	ST	B01T02
31	TFT00832	Probeimplantat Höhe 8 mm 0° 32/12		1	ST	B01T02
32	TFT00928	Probeimplantat Höhe 9 mm 0° 28/10		1	ST	B01T02
33	TFT00932	Probeimplantat Höhe 9 mm 0° 32/12		1	ST	B01T02

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service





Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuySynthes.com



**L1100001572**


**Conduit Curved TLIF Instrumente**

34	TFT01028	Probeimplantat Höhe 10 mm 0° 28/10		1	ST	B01T02
35	TFT01032	Probeimplantat Höhe 10 mm 0° 32/12		1	ST	B01T02
36	TFT01128	Probeimplantat Höhe 11 mm 0° 28/10		1	ST	B01T02
37	TFT01132	Probeimplantat Höhe 11 mm 0° 32/12		1	ST	B01T02
38	TFT01332	Probeimplantat Höhe 13 mm 0° 32/12		1	ST	B01T02
39	TFT30928	Probeimplantat Höhe 9 mm 12° 28/10		1	ST	B01T02
40	TFT30932	Probeimplantat Höhe 9 mm 12° 32/12		1	ST	B01T02
41	TFT31128	Probeimplantat Höhe 11 mm 12° 28/10		1	ST	B01T02
42	TFT31132	Probeimplantat Höhe 11 mm 12° 32/12		1	ST	B01T02
43	TFT31328	Probeimplantat Höhe 13 mm 12° 28/10		1	ST	B01T02
44	TFT31332	Probeimplantat Höhe 13 mm 12° 32/12		1	ST	B01T02
45	TFT80828	Probeimplantat Höhe 8 mm 8° 28/10		1	ST	B01T02
46	TFT80832	Probeimplantat Höhe 8 mm 8° 32/12		1	ST	B01T02
47	TFT80928	Probeimplantat Höhe 9 mm 8° 28/10		1	ST	B01T02
48	TFT80932	Probeimplantat Höhe 9 mm 8° 32/12		1	ST	B01T02
49	TFT81028	Probeimplantat Höhe 10 mm 8° 28/10		1	ST	B01T02
50	TFT81032	Probeimplantat Höhe 10 mm 8° 32/12		1	ST	B01T02
51	TFT81128	Probeimplantat Höhe 11 mm 8° 28/10		1	ST	B01T02
52	TFT81132	Probeimplantat Höhe 11 mm 8° 32/12		1	ST	B01T02
53	TFT81328	Probeimplantat Höhe 13 mm 8° 28/10		1	ST	B01T02
54	TFT81332	Probeimplantat Höhe 13 mm 8° 32/12		1	ST	B01T02
	Einsatz zu TEC00101			1	ST	B01T02


## L1100001572

## Conduit Curved TLIF Instrumente

B01T01

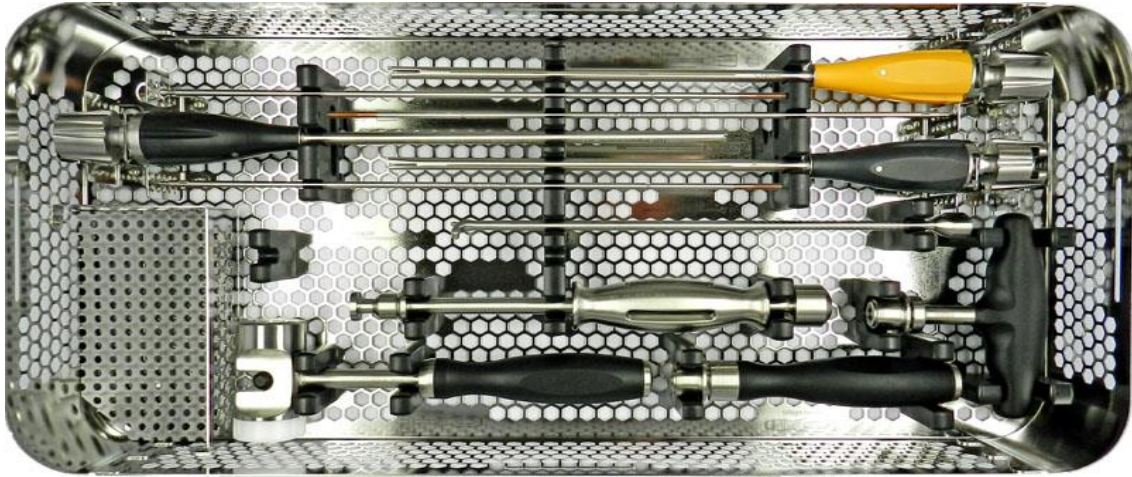

B01T02

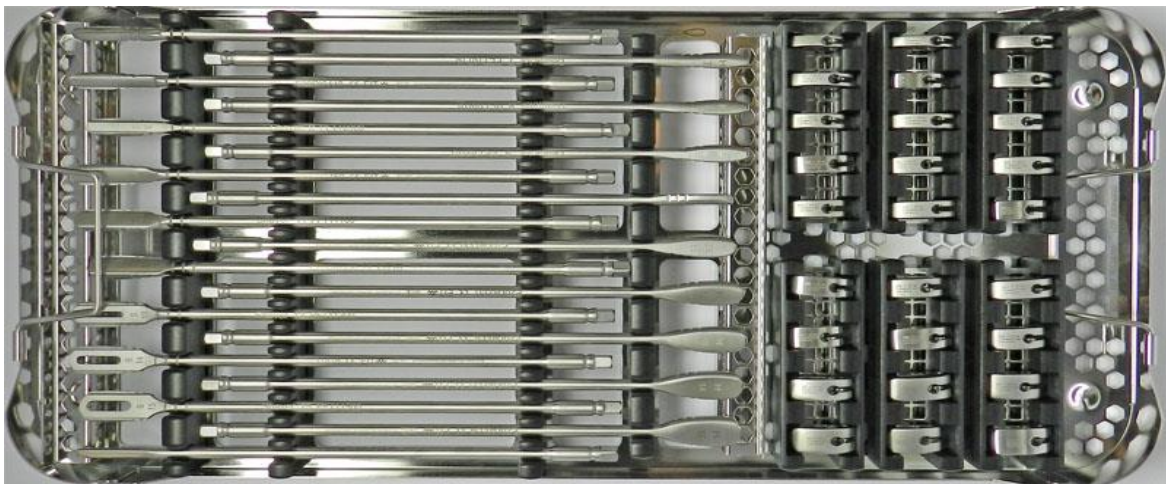

\*\*\*End of document\*\*\*